



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Fibrinogen Report Coagulation Program

Ciclo 11

Apr 2023 – Apr 2024
Campione N°: 10
Data del campione: 15 Gen 24
lotto n°: 281000



Instrumentation Laboratory ACL TOP Se...

Il tuo risultato
102 mg/dL


Comparazione statistica

La tua deviazione

	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ Tutti i risultati	933	104	12,5	12,1	1,02	-0,12	-0,69	-1,47
■ Metodo	682	103	13,5	13,2	1,30	-0,04	-0,60	-0,531
● Gruppo omogeneo	171	102	6,41	6,26	1,23	-0,07	-0,74	-0,408


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



TUTTI I RISULTATI

Il tuo risultato



	N	Media	CV	U ¹
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... Foto-Ottico Reattivi/kit dedicati	171	102	6,26	1,23
Sysmex CS-Systems Foto-Ottico Siemens Dade Thrombin REF B4233-25/27	124	92,9	10,4	2,17
Diagnostica Stago Series Elettromeccanico Stago STA-Liquid Fib	119	102	5,60	1,31
Siemens BCS/BCT/BFA/BFT Foto-Ottico Siemens Multifibren U REF OWZG	57	133	12,3	5,44
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... Calcolato IL HemosIL RecombiPlasTin 2G	51	152	28,6	15,2
Sysmex CA Series Foto-Ottico Siemens Dade Thrombin REF B4233-25/27	44	97,3	8,76	3,21
Sysmex CS-Systems Foto-Ottico Siemens Dade Fibrinogen REF B4233	30	92,9	12,0	5,08
Roche cobas t 411 (Behnk Elektronik) Foto-Ottico Roche cobas Fibrinogen, REF 07103441	28	99,0	9,95	4,65
Instrumentation Laboratory ACL 8000... Foto-Ottico IL HemosIL Q.F.A. Thrombin	26	131	26,8	17,2

Fibrinogen 11:10
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Proteina C, attività Report Coagulation Program

Ciclo 11

Apr 2023 – Apr 2024

Campione N°: 10

Data del campione: 15 Gen 24

lotto n°: 281000



External Quality Assurance Services

Instrumentation Laboratory ACL TOP Se...

Il tuo risultato

36 %

◆ Tutti i risultati

■ Metodo

● Gruppo omogeneo


Comparazione statistica

	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
Tutti i risultati	152	34,3	3,07	8,93	0,622	0,54	0,19	4,85
Metodo	131	34,3	2,79	8,12	0,609	0,60	0,25	4,89
Gruppo omogeneo	13	33,4	1,44	4,30	0,996	1,81	0,88	7,76

La tua deviazione


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato





METODO

Il tuo risultato




TUTTI I RISULTATI

Il tuo risultato

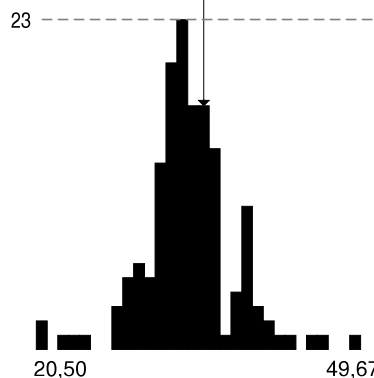

	N	Media	CV	U ¹
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... Cromogenico IL HemosIL Protein C REF 0020300500	39	33,2	5,08	0,674
Sysmex CS-Systems Cromogenico Siemens Berichrom Protein C	27	34,8	10,9	1,83
Diagnostica Stago Series Cromogenico Stago STA-Stachrom Protein C	18	36,9	5,87	1,28
Siemens BCS/BCT/BFA/BFT Cromogenico Siemens Berichrom Protein C	13	34,6	4,00	0,960
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... Cromogenico Reattivi/kits dedicati	13	33,4	4,30	0,996
Diagnostica Stago Series Cromogenico Reattivi/kits dedicati	9	36,0	4,84	1,45
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... Foto-Ottico IL HemosIL ProClot REF 0008468310	7	29,7	13,0	3,66
Sysmex CS-Systems Foto-Ottico Siemens Protein C REF OQYG	6	39,5	11,1	4,49
Roche cobas t Series Cromogenico Roche Protein C Chrom, REF 06660525	4	29,1	0,948	0,344



Proteina C, attività 11 : 10

CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

T.di Protromb(TP),ISI<=1,4 Report Coagulation Program

Ciclo 11

Apr 2023 – Apr 2024
Campione N°: 10
Data del campione: 15 Gen 24
lotto n°: 281000



Instrumentation Laboratory ACL TOP Se...






Il tuo risultato
20,7 Secondi

- ◆ La tua popolazione
- Metodo
- Gruppo omogeneo

Comparazione statistica

	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
La tua popolazione	650	19,6	1,95	9,94	0,191	0,57	-0,29	5,70
Metodo	284	20,9	1,08	5,17	0,160	-0,16	-0,96	-0,840
Gruppo omogeneo	201	20,8	0,886	4,27	0,156	-0,08	-1,02	-0,363

La tua deviazione

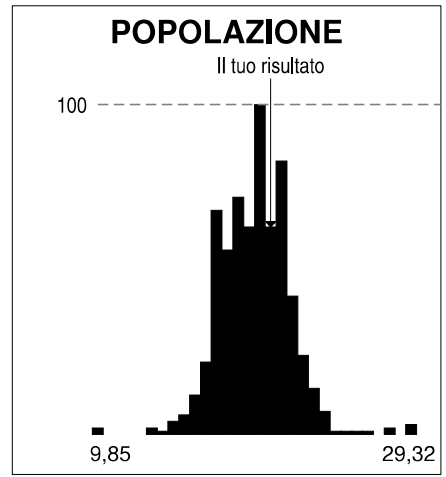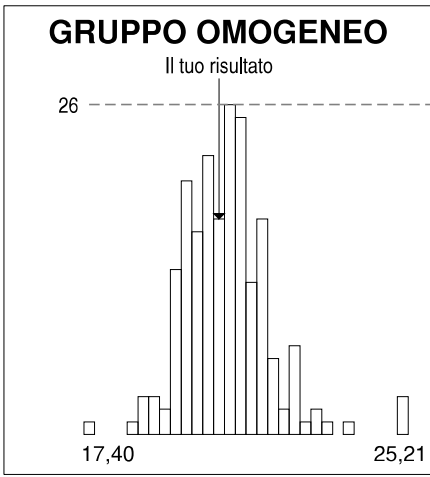

	N	Media	CV	U ¹
Instrumentation Laboratory ACL TOP ... IL HemosL. RecombiPlasTin 2G Reattivi/kit dedicati	201	20,8	4,27	0,156
Diagnostica Stago Series Diagnostica Stago STA NeoPTimal Reattivi/kit dedicati	107	25,1	5,28	0,320
Sysmex CS-Systems Siemens Thromborel S Reattivi/kit dedicati	98	18,4	4,59	0,213
Sysmex CA Series Siemens Thromborel S Reattivi/kit dedicati	89	17,7	5,50	0,258
Instrumentation Laboratory ACL 8000... IL HemosL. RecombiPlasTin 2G Reattivi/kit dedicati	74	21,3	6,69	0,415
Metodo manuale Siemens Innovin Reattivi/kit dedicati	63	15,3	5,13	0,247
Sysmex CA Series Siemens Innovin Reattivi/kit dedicati	56	15,4	3,19	0,164
Sysmex CS-Systems Siemens Innovin Reattivi/kit dedicati	53	15,8	3,08	0,167
Siemens BCS/BCT/BFA/BFT Siemens Thromborel S Reattivi/kit dedicati	29	19,1	3,67	0,325

T.di Protromb(TP),ISI<=1,4 11 :10
CICLO CAMP.