



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HAV Ab, IgG Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...





Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	67	3,16	0,961	30,4	0,293	1,35	1,48	41,0
■ Metodo	66	3,18	0,988	31,0	0,304	1,29	1,46	40,1
● Gruppo omogeneo	32	2,56	0,502	19,6	0,222	3,77	1,99	73,9

Il tuo risultato

4,46 Sample/Cuto...



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	34	3,58	24,2	0,372
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	32	2,56	19,6	0,222
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	4	1,47	3,04	0,056
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	1	0	0	0
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	1	0	0	0
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	1	0	0	0
Metodo manuale EIA Reattivi/kit dedicati	1	0,400	0	0
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... EIA Reattivi/kit dedicati	1	2,67	0	0



HAV Ab, IgG 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HAV Ab, IgM Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	92	0,106	0,033	31,2	0,009	-1,99	-0,80	-62,2
■ Metodo	105	0,103	0,035	33,5	0,008	-1,83	-0,67	-61,2
○ Gruppo omogeneo	45	0,097	0,028	28,6	0,010	-2,06	-0,56	-58,8

Il tuo risultato

0,04 Sample/Cuto...


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



POPOLAZIONE

Il tuo risultato



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	45	0,097	28,6	0,010
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	35	0,130	32,7	0,018
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	28	0,274	11,7	0,015
Siemens Atellica IM Analyzer Chemiluminescenza Siemens Atellica Reagent	8	0,111	45,0	0,044
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	8	0,296	12,1	0,032
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	7	0,106	45,0	0,045
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	5	0,022	43,1	0,011
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	5	0,010	4,38	0,000
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche Elecsys Anti-HAV IgM REF 07026773	4	0,273	1,96	0,007

HAV Ab, IgM 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HBc Ab, IgM Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...






Comparazione statistica

La tua deviazione

	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	87	0,075	0,015	20,3	0,004	-0,96	-0,91	-19,5
■ Metodo	81	0,081	0,016	19,9	0,005	-1,32	-1,00	-26,3
● Gruppo omogeneo	34	0,078	0,012	15,8	0,005	-1,48	-0,99	-23,3

Il tuo risultato

0,06 Sample/Cuto...



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	34	0,078	15,8	0,005
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	28	0,082	13,2	0,005
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	14	0,060	8,03	0,003
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	7	0,053	6,00	0,003
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	5	0,147	32,4	0,053
Siemens Atellica IM Analyzer Chemiluminescenza Siemens Atellica Reagent	5	0,131	22,7	0,033
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	4	0,033	15,4	0,003
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche Elecsys Anti-HBc IgM REF 07026811	4	0,066	10,1	0,008
Beckman Coulter UniCel Dxl Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	3	0,027	21,7	0,004

HBc Ab, IgM 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HbC Ab, Total Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	110	8,42	1,06	12,6	0,253	-1,14	0,13	-14,4
■ Metodo	142	8,20	1,34	16,3	0,280	-0,74	0,25	-12,1
● Gruppo omogeneo	63	8,95	1,01	11,3	0,317	-1,72	0,03	-19,4

Il tuo risultato

7,21 Sample/Cuto...


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



POPOLAZIONE

Il tuo risultato



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	63	8,95	11,3	0,317
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	47	7,80	8,51	0,242
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	24	0,007	11,2	0,000
Siemens IMMULITE 2000/2500/XPi Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	9	5,86	6,11	0,299
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	8	0,048	34,2	0,014
Beckman Coulter UniCel DxI Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	7	189	9,76	17,4
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche ECL Anti HbC II REF 07374160	7	0,008	18,7	0,001
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche Elecsys Anti-HBc II REF 07026790	7	0,007	22,8	0,002
Siemens Atellica IM Analyzer Chemiluminescenza Siemens Atellica Reagent	4	8,15	3,74	0,191

HbC Ab, Total 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HBe Ab, Total Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	70	2,01	0,110	5,48	0,033	0,39	0,85	2,15
■ Metodo	82	1,96	0,140	7,12	0,039	0,62	0,91	4,42
● Gruppo omogeneo	35	2,02	0,125	6,19	0,053	0,21	0,68	1,31

Il tuo risultato

2,05 Sample/Cuto...


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



POPOLAZIONE

Il tuo risultato

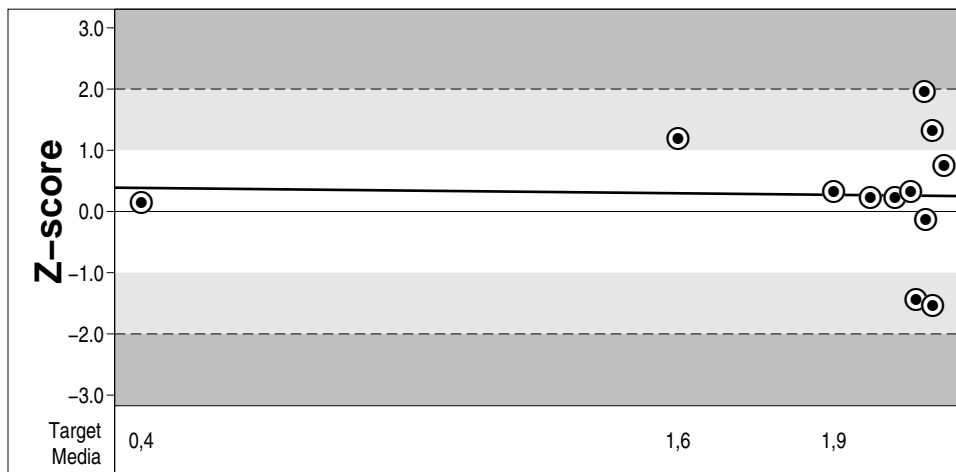

	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	35	2,02	6,19	0,053
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	33	1,99	4,90	0,042
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	16	1,36	4,05	0,034
Siemens Atellica IM Analyzer Chemiluminescenza Siemens Atellica Reagent	6	0,116	22,5	0,027
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	5	0,148	3,02	0,002
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	5	1,34	1,38	0,021
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	3	0,157	18,2	0,041
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche Elecsys Anti-HBe REF 07026838	3	1,31	1,32	0,013
DiaSorin LIAISON/XL EIA Reattivi/kit dedicati	2	2,09	6,14	0,227

HBe Ab, Total 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HBs Ag Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Il tuo risultato
6189 Sample/Cuto...





- ◆ La tua popolazione
- Metodo
- Gruppo omogeneo

Comparazione statistica


	N	Media	SD	CV	U ¹
La tua popolazione	332	7038	1333	18,9	183
Metodo	255	6429	837	13,0	131
Gruppo omogeneo	132	6807	649	9,53	141

La tua deviazione

	Z-score	RMZ	%
La tua popolazione	-0,64	0,15	-12,1
Metodo	-0,29	0,21	-3,74
Gruppo omogeneo	-0,95	0,01	-9,08

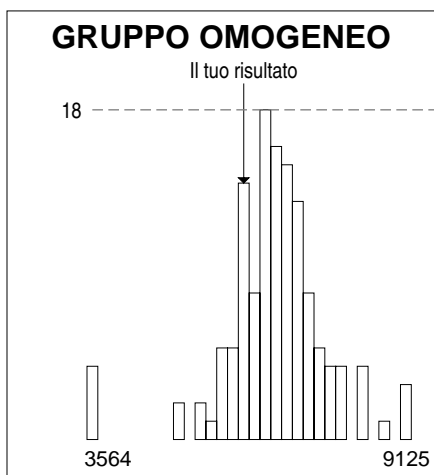

	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	132	6807	9,53	141
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	66	8491	14,5	379
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	58	6532	7,00	150
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	39	8861	11,6	412
DiaProph Med EIA DiaProph Med DIA-HBsAg REF T1-200X	19	42,7	19,9	4,87
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche ECL e 801	18	2132	9,36	118
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	16	6281	6,73	264
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	12	1000	0,029	0,104
Beckman Coulter UniCel Dxl Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	11	925	4,96	34,5



HBs Ag 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HCV Ab, Total Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	309	0,150	0,063	41,8	0,009	-0,48	0,18	-20,1
■ Metodo	268	0,157	0,059	37,5	0,009	-0,63	-0,01	-23,5
● Gruppo omogeneo	135	0,138	0,033	23,7	0,007	-0,55	0,47	-13,0

Il tuo risultato

0,12 Sample/Cuto...


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



POPOLAZIONE

Il tuo risultato



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	135	0,138	23,7	0,007
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	63	0,049	9,94	0,002
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	59	0,184	25,5	0,015
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	36	0,087	10,7	0,004
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	30	0,162	31,5	0,023
DiaProph Med EIA DiaProph Med DIA-HCV-III REF T1-210X	19	0,070	74,5	0,030
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	17	0,161	22,4	0,022
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche ECL e 801	16	0,047	7,85	0,002
Vector-Best EIA Vector-Best D-077X/749, HCV Ab, Total	12	0,035	91,3	0,023

HCV Ab, Total 6 : 7
CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

HIV Ag-Ab Report HIV/Hepatitis Program (Quantitative)

Ciclo 6

Mar 2021 – Mar 2022

Campione N°: 7

Data del campione: 15 Set 21

lotto n°: 330500



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione


	N	Media	SD	CV	U ¹	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	179	0,076	0,024	32,1	0,005	-0,23	0,14	-7,29
■ Metodo	236	0,087	0,032	36,9	0,005	-0,53	0,09	-19,7
● Gruppo omogeneo	119	0,083	0,017	20,5	0,004	-0,76	-0,19	-15,7

Il tuo risultato

0,07 Sample/Cuto...


GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato






METODO

Il tuo risultato



POPOLAZIONE

Il tuo risultato



	N	Media	CV	U ¹
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	119	0,083	20,5	0,004
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	58	0,055	20,2	0,004
Roche cobas 6000/8000/c 311 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	47	0,322	28,9	0,034
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	27	0,291	26,7	0,037
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	23	0,534	21,9	0,061
Bio-Rad Genscreen ULTRA EIA Reattivi/kit dedicati	17	0,378	24,9	0,057
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	11	0,141	35,0	0,037
DiaProph Med EIA DiaProph Med DIA-HIV-Ag/Ab REF T1-150X	11	0,322	28,0	0,068
Roche cobas e 801 Elettrochemiluminescenza (ECL) Roche e 801 HIV Duo REF 07229542	11	0,211	11,6	0,018

HIV Ag-Ab 6 : 7
CICLO CAMP.